
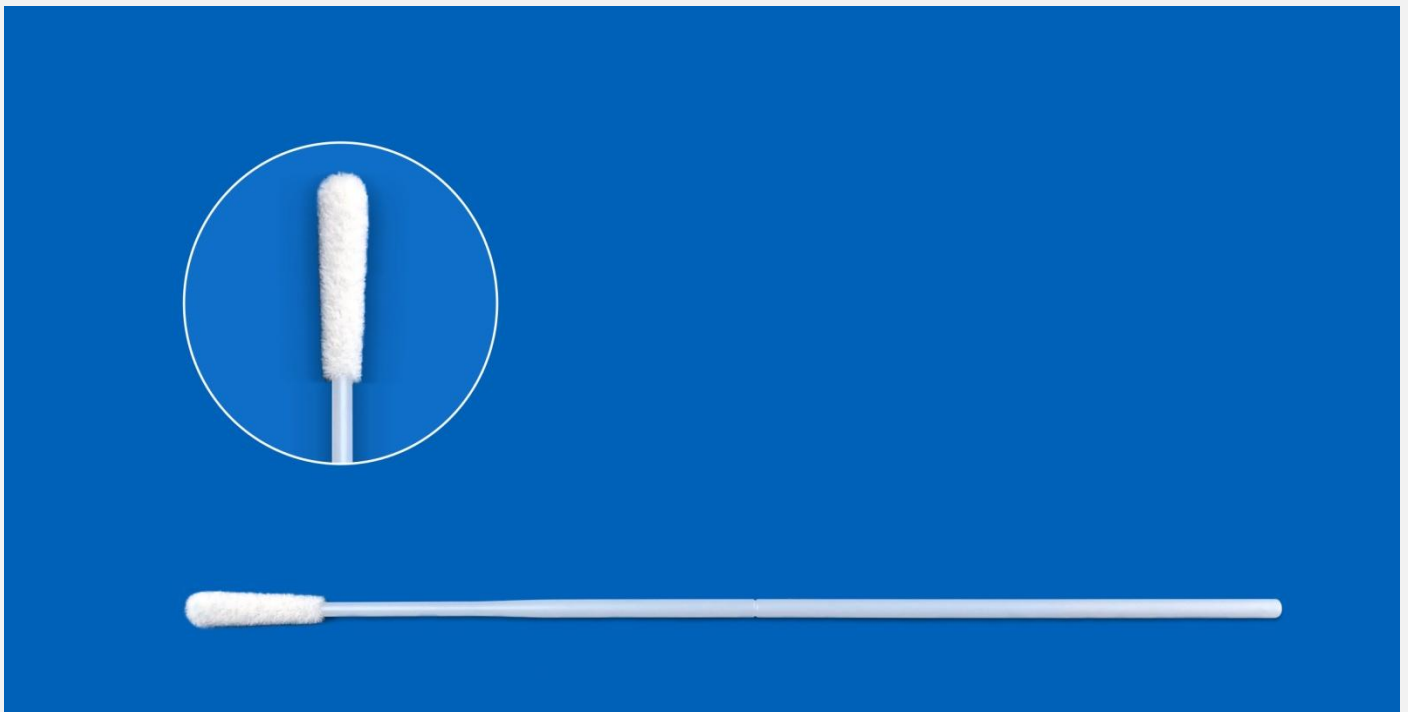


**MS-LF7801 植绒(咽喉)采样拭子**, 总长度 **150mm** 折断口 **78mm**, 采样杆材质为 **PS**。

LF7801 植绒拭子主要用于咽喉的样本采集, OF3601 与 LF7801 都是口咽植绒拭子, 2 者最大的区别是折断口的长度不同, 36mm 的折断口对应 2ml 的保存瓶, 78mm 的对应 10ml 的采样瓶。

### 产品尺寸图及照片

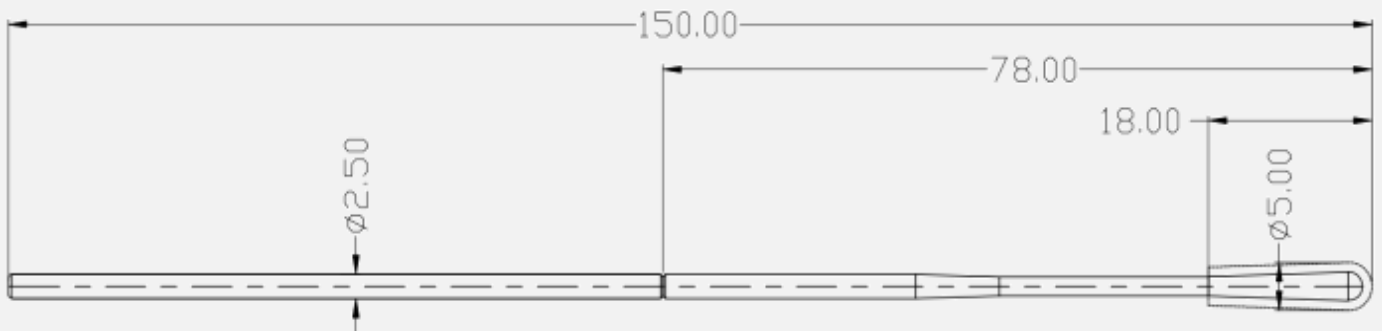

### 灭菌方式及产品性能

我们采用 E0 灭菌, 出厂时环氧乙烷残留值不高于 10ug/g。产品存储温度为 5-35 度, 有效期为 3 年。